


#脳温自動制御の全経過

10日間にわたって脳温を自動制御し、良好な結果を得た

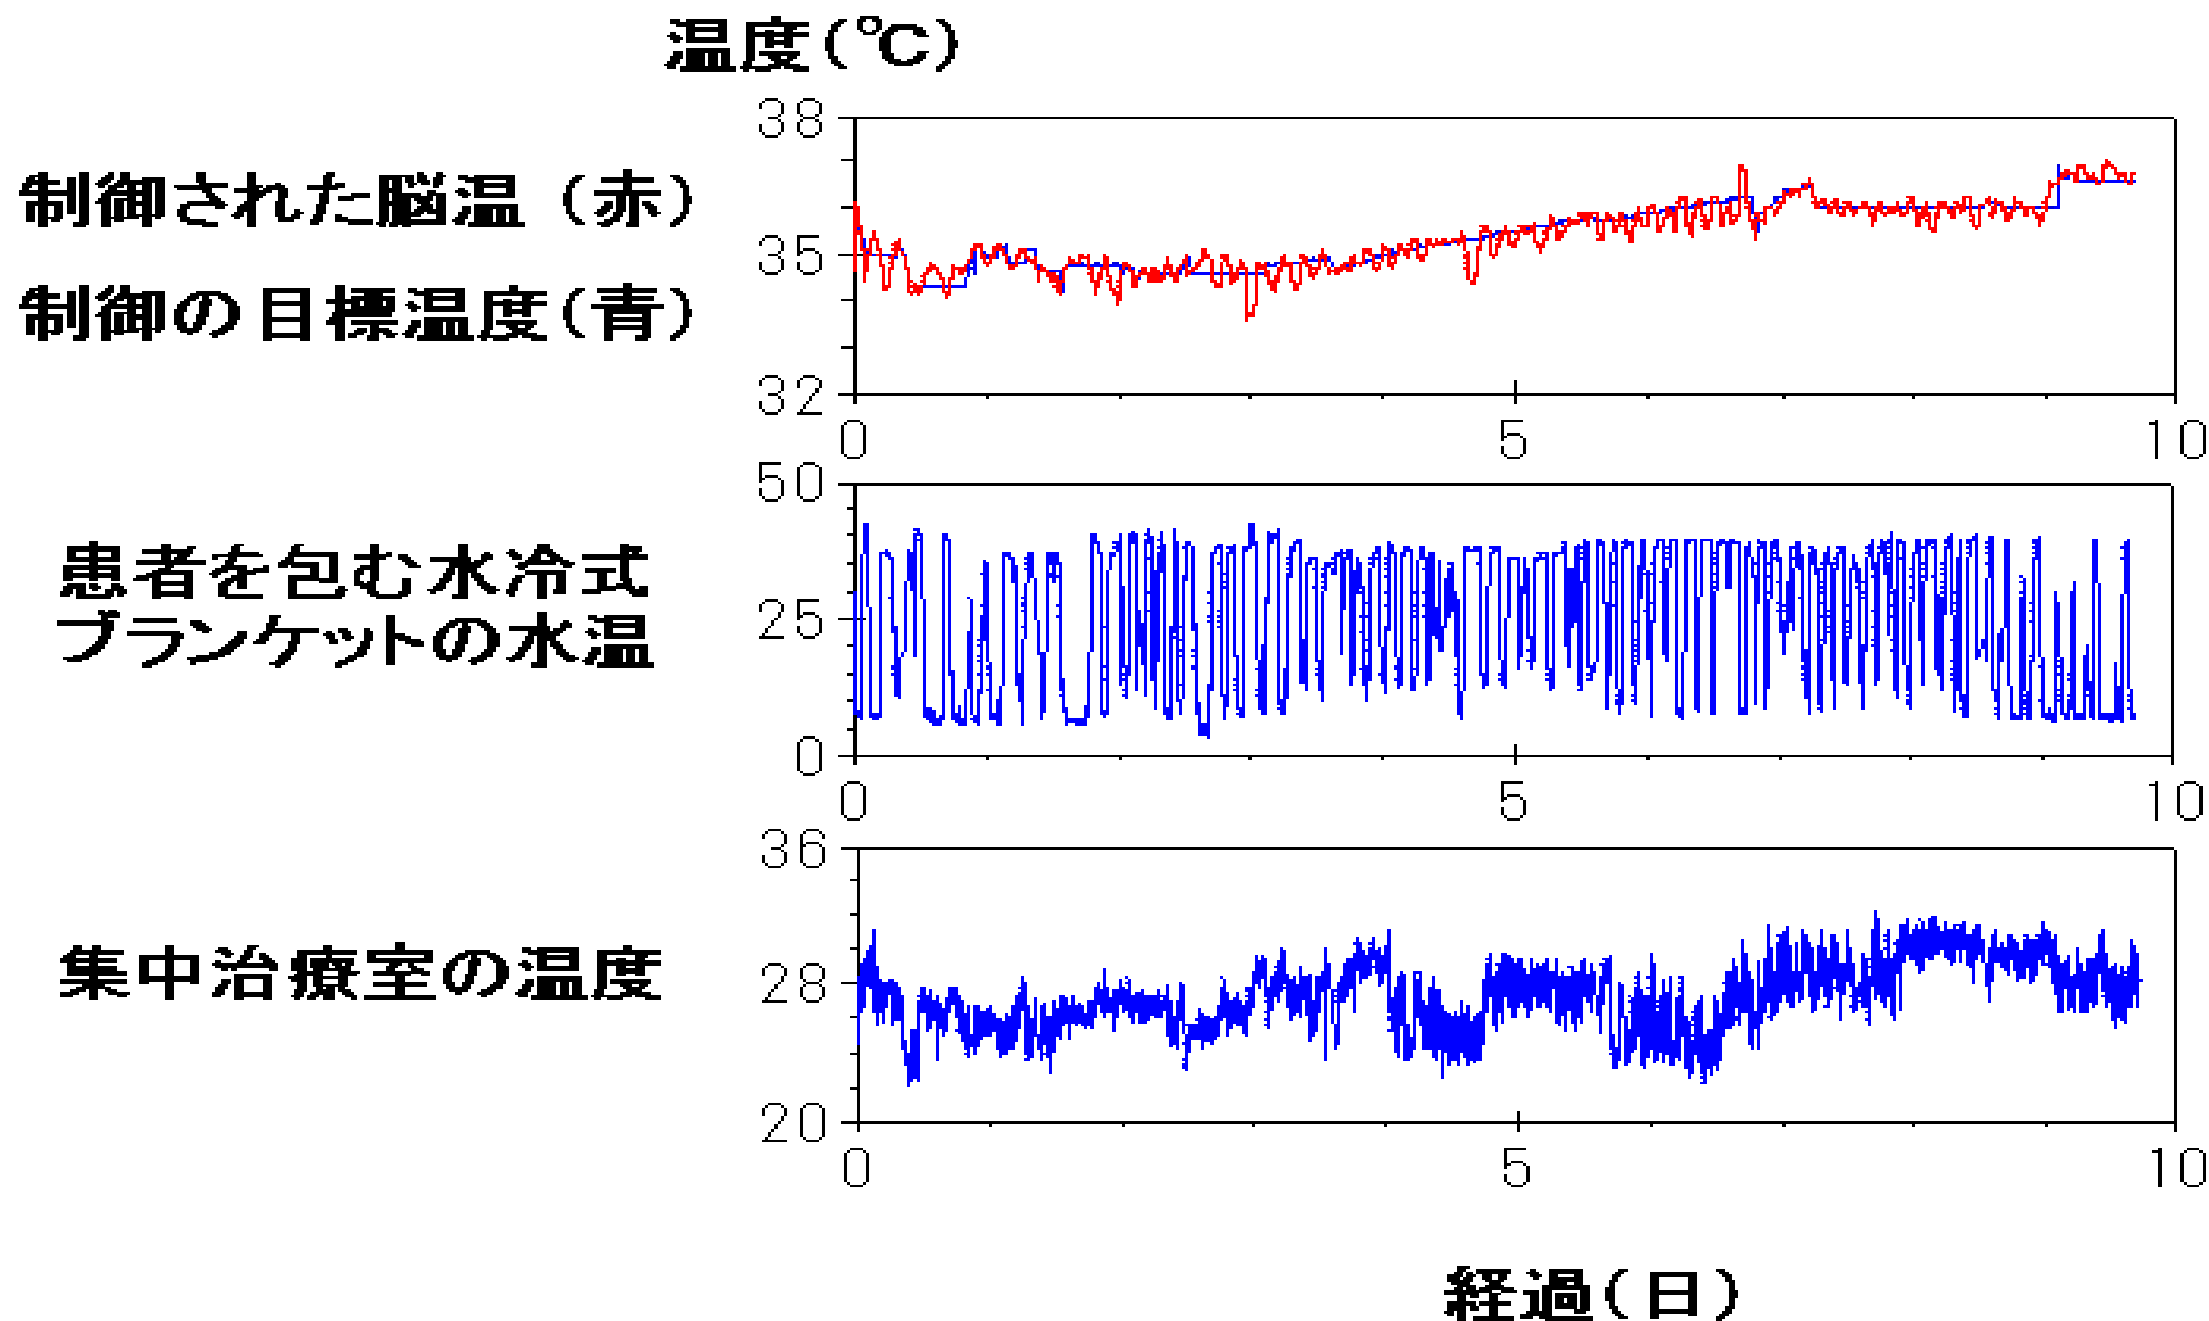

#10時間にわたる脳温自動制御の経過

室温が変化しても、目標の35°Cに脳温をよく制御した

